



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

ENQUETE SSSH 2009

Résultats des hôpitaux suisses

Développement des Stérilisations centrales

- But du sondage
- Période couverte par le sondage
- Questionnaires envoyés
- Questionnaires renvoyés / remplis


Les 10 chapitres du sondage

- Etablissement
- Salaire + Formation et Compétences
- Transport
- Lavage et désinfection
- Emballage
- Stérilisation
- Réparation et stock
- Différents contrôles
- Documentation et traçabilité
- SSSH

Important!


- Limitations
 - nombre de questionnaires renvoyés
 - questionnaires non renvoyés et distorsion possible des résultats
 - questions et leur interprétation

Statut de l'établissement

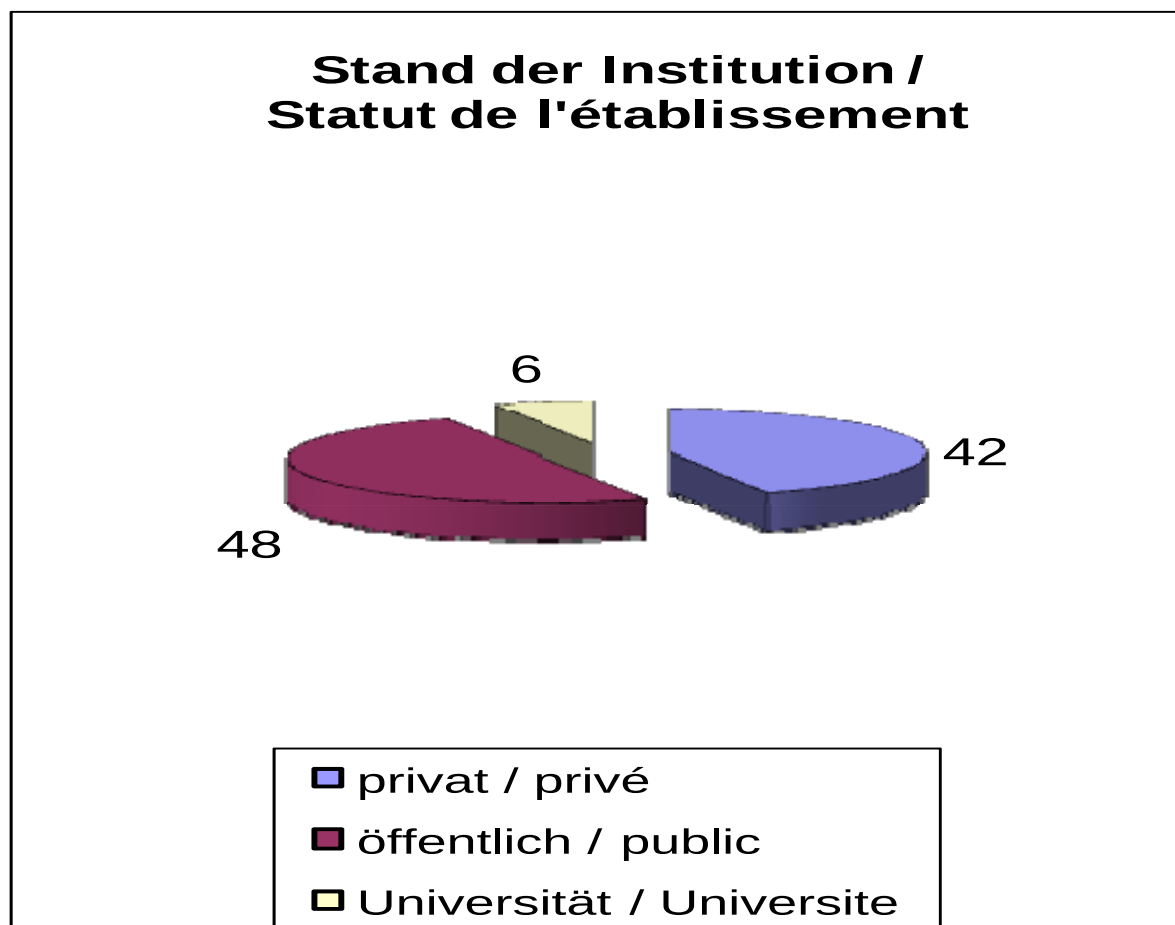

Nombre de lits


Bettenzahl / Nombre de lits

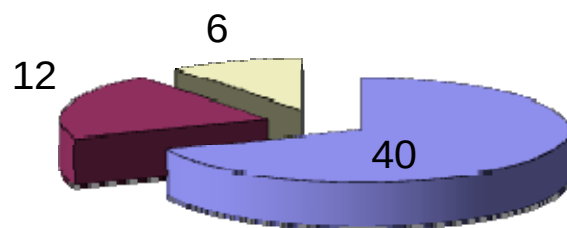

■ unter 200 / moins que 200
■ 200 bis 500 / 200 à 500
■ über 500 / plus que 500


Quantité totale

Bettenzahl / Nombre de lits

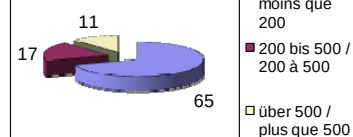

DE

Bettenzahl / Nombre de lits

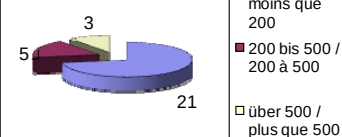


FR

Bettenzahl / Nombre de lits




IT



Rattachement du service

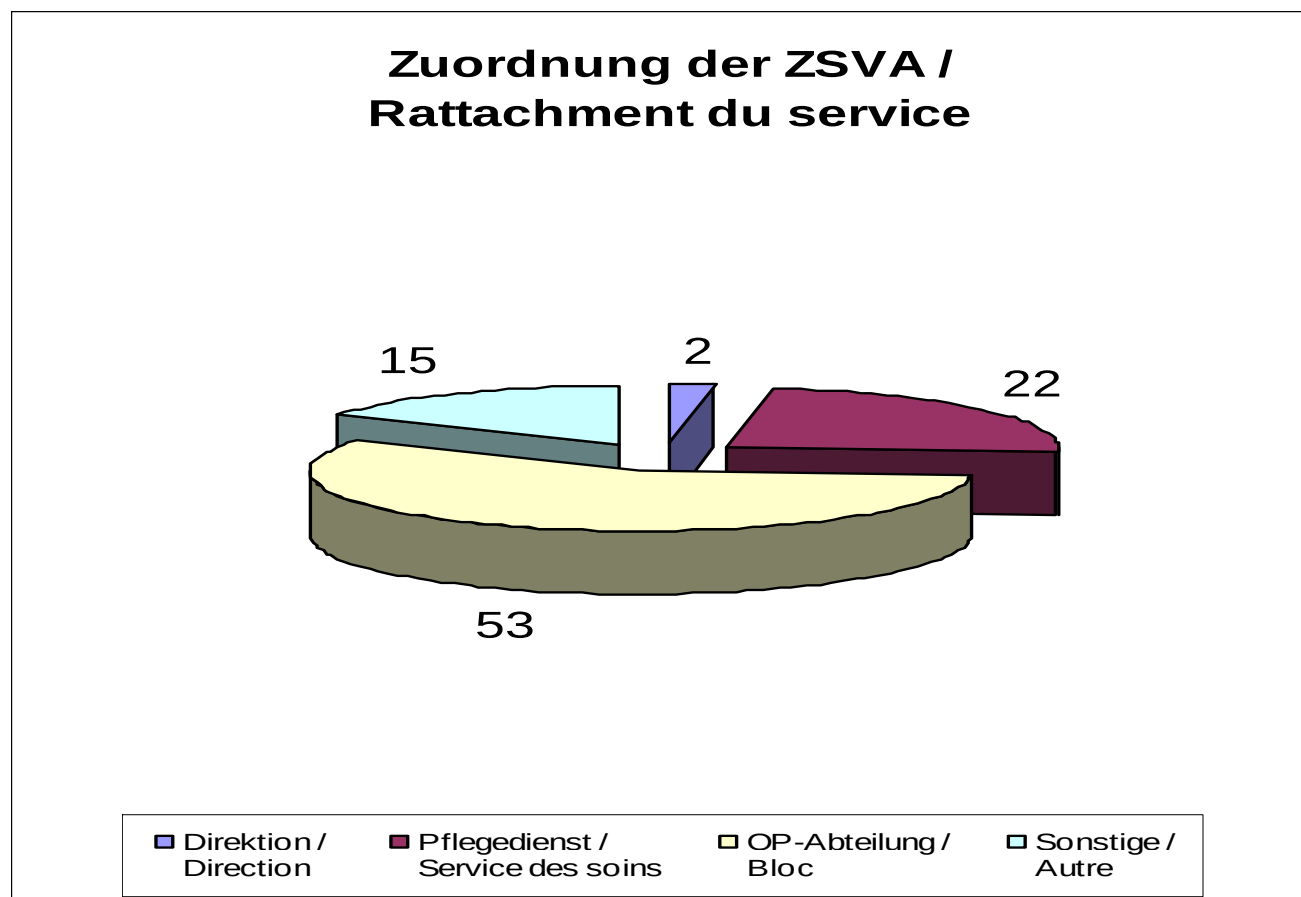


Formation du responsable

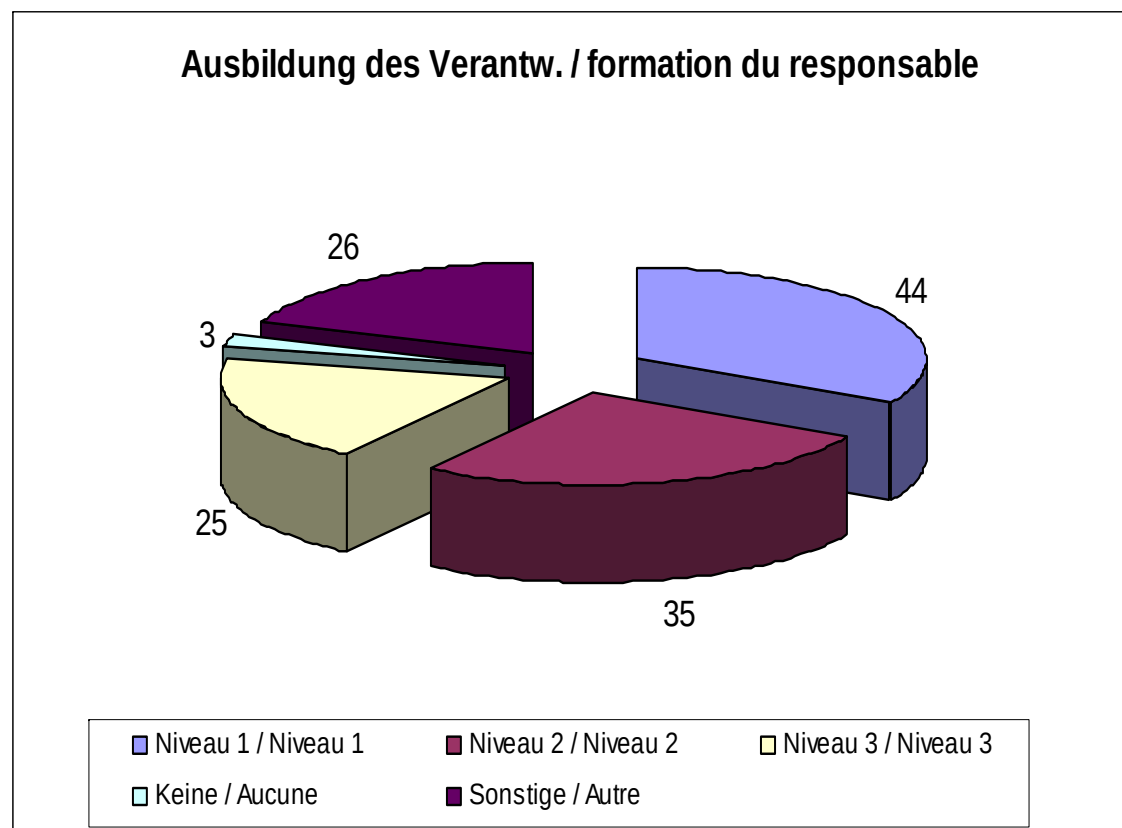





Certification du service

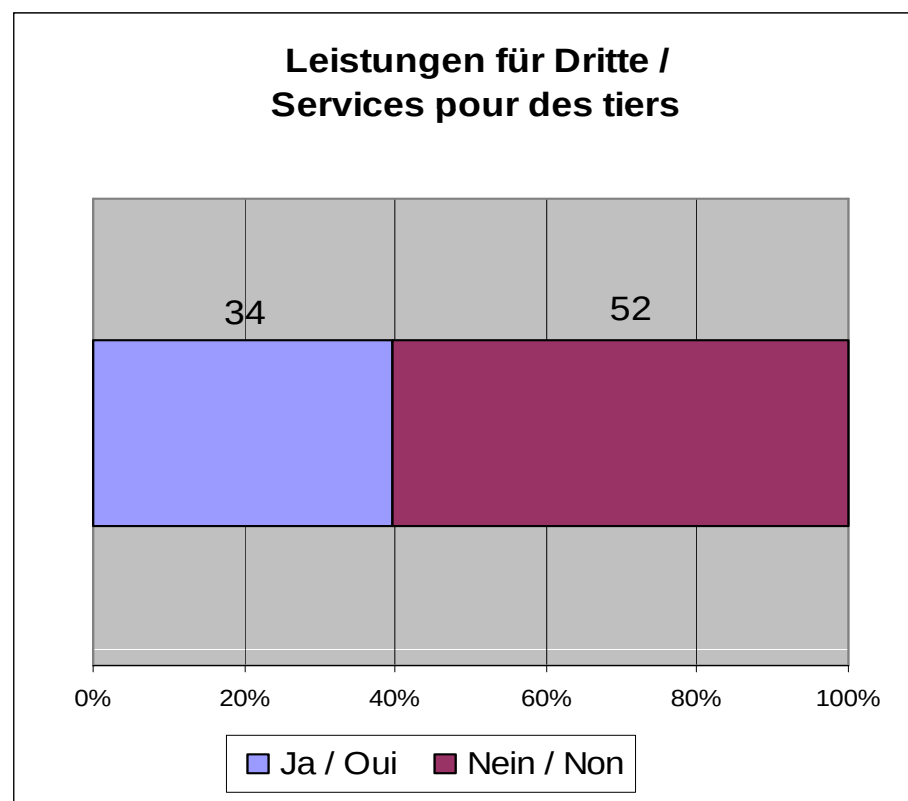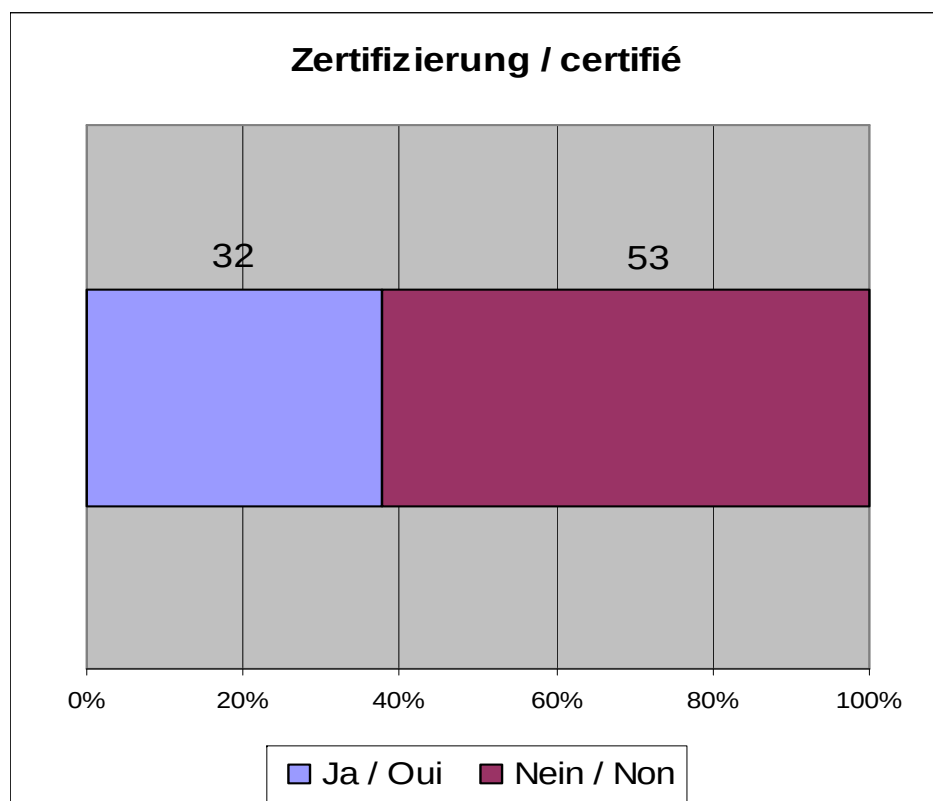


Formation des collaborateurs

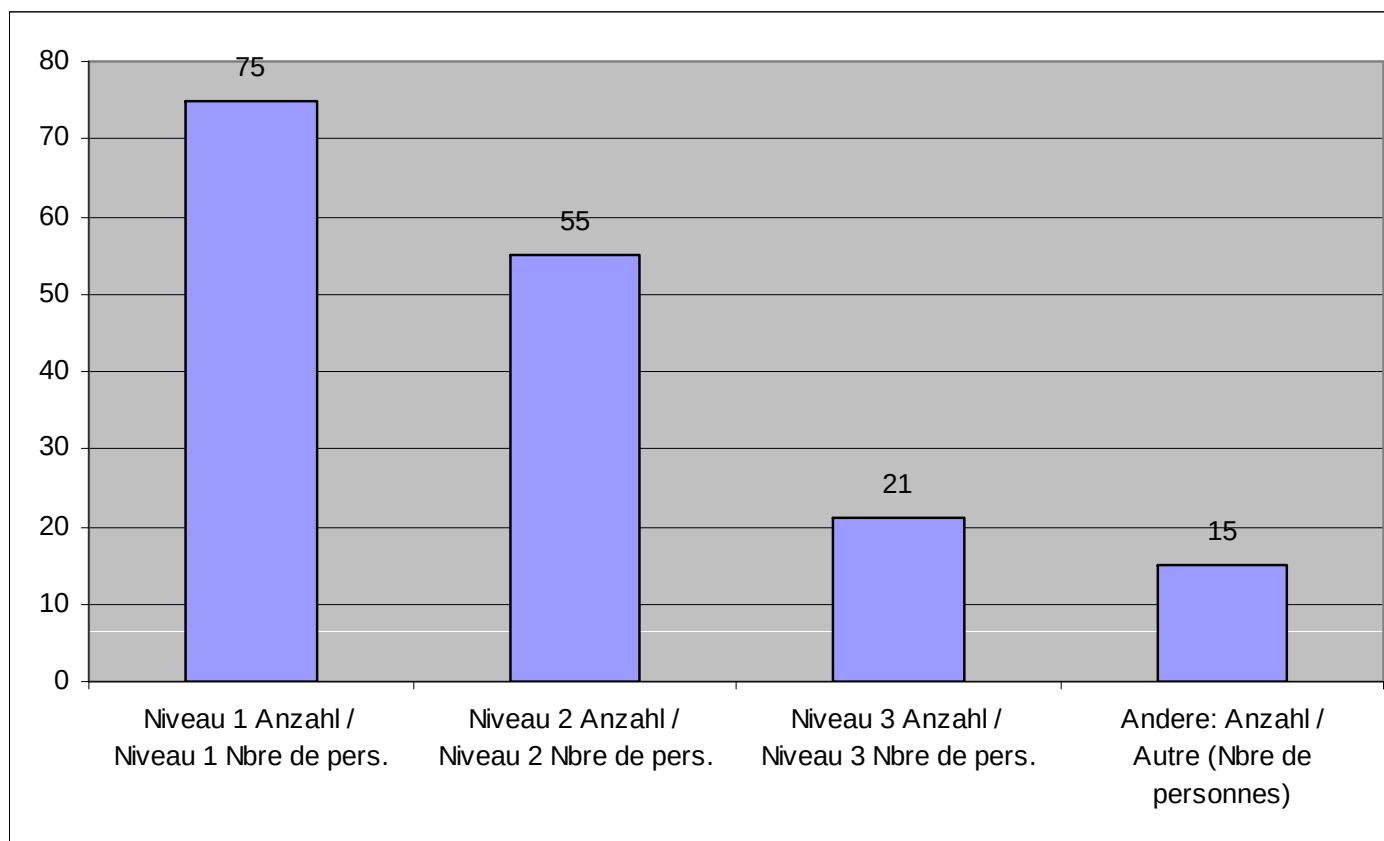


Salaire annuel brut

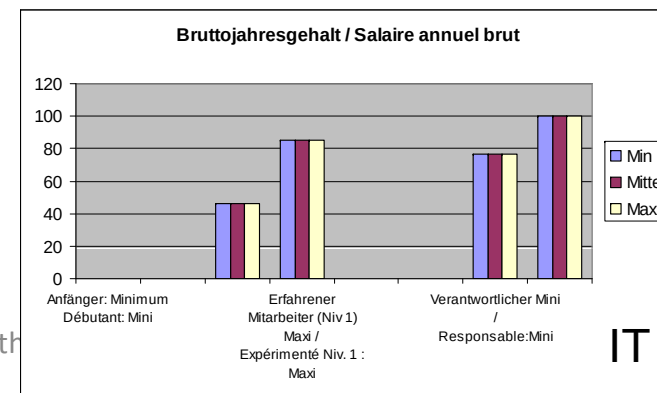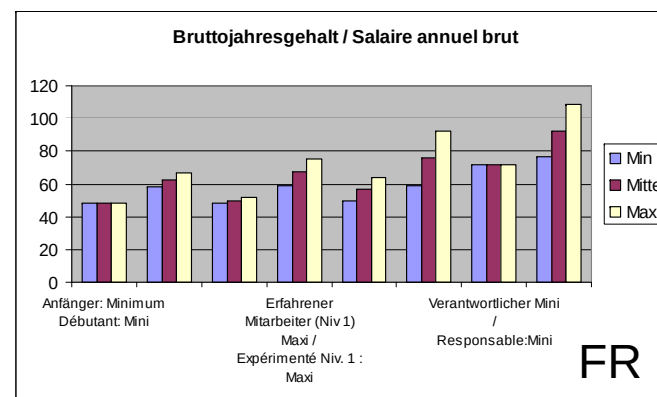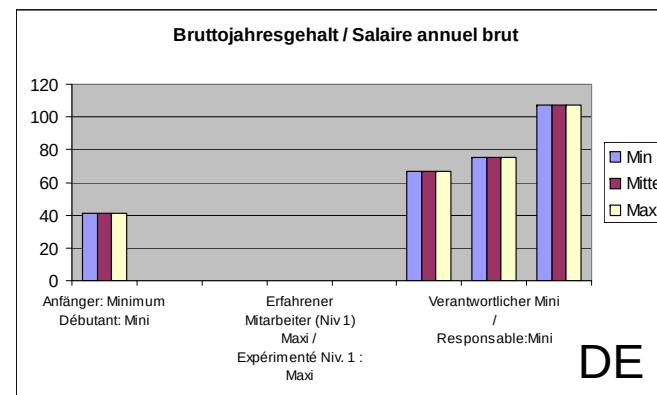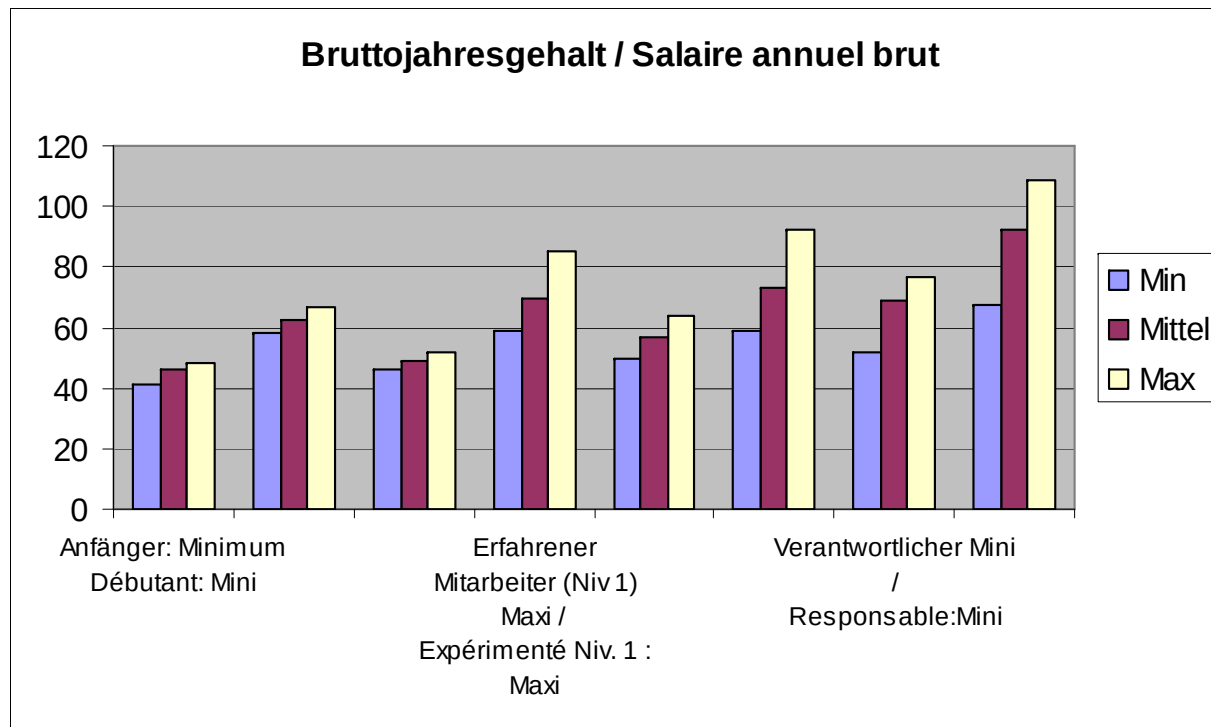



Implication du personnel du bloc dans le travail de la stérilisation

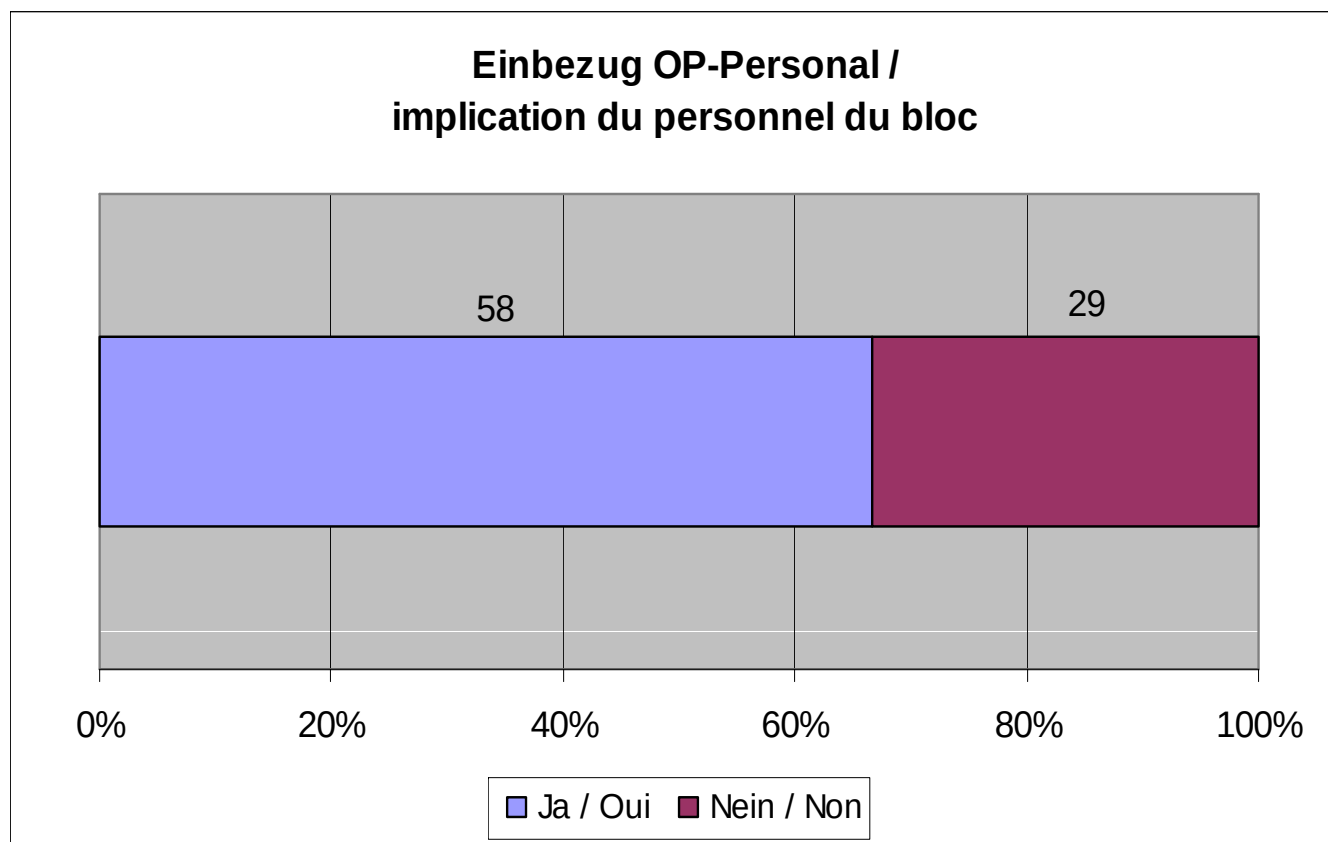

Une pré-désinfection est-elle effectuée?

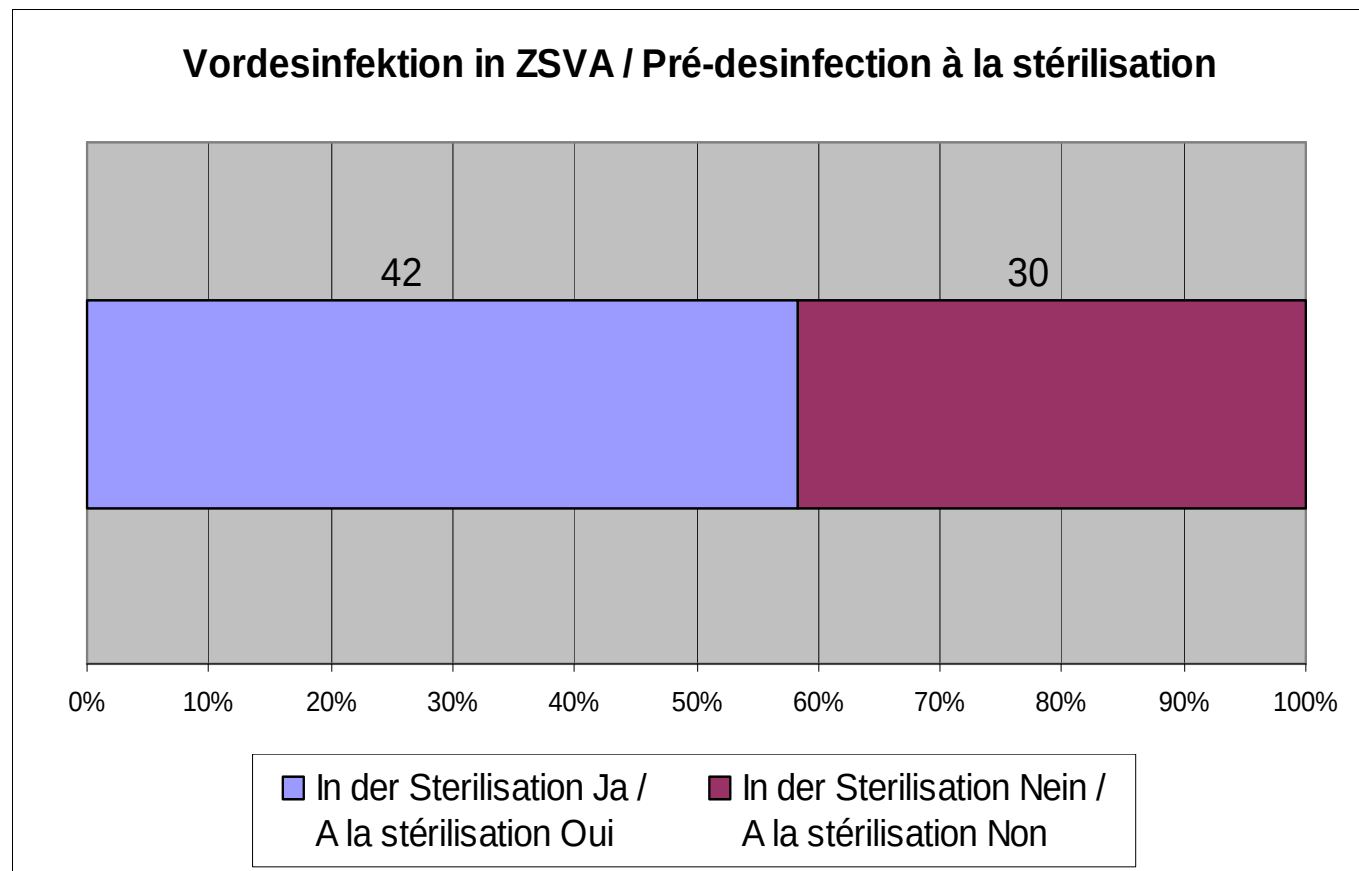


LD

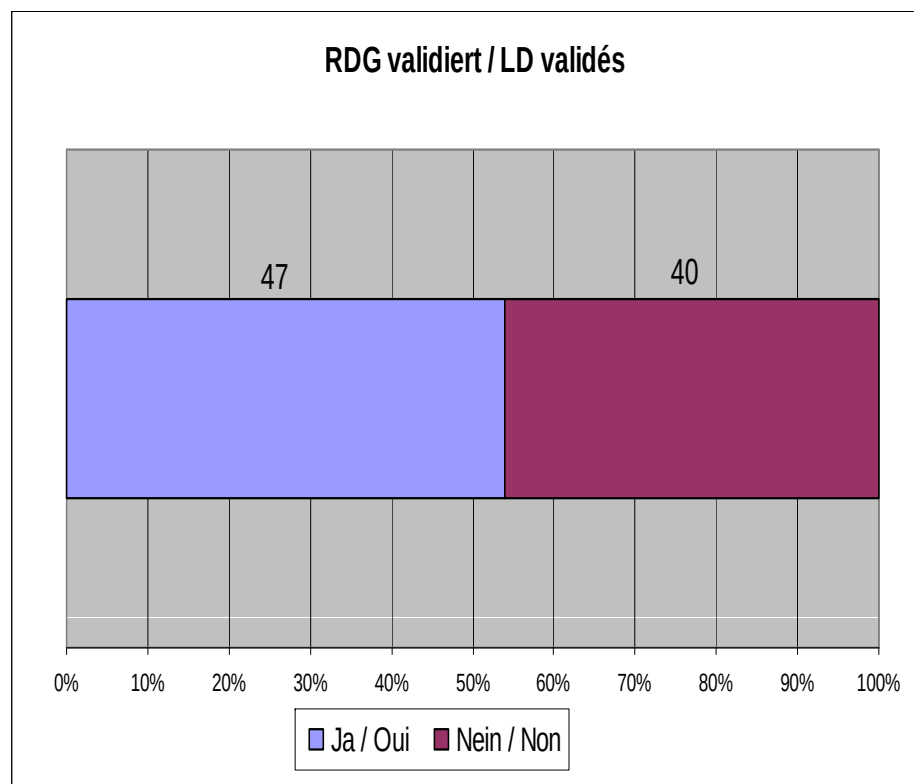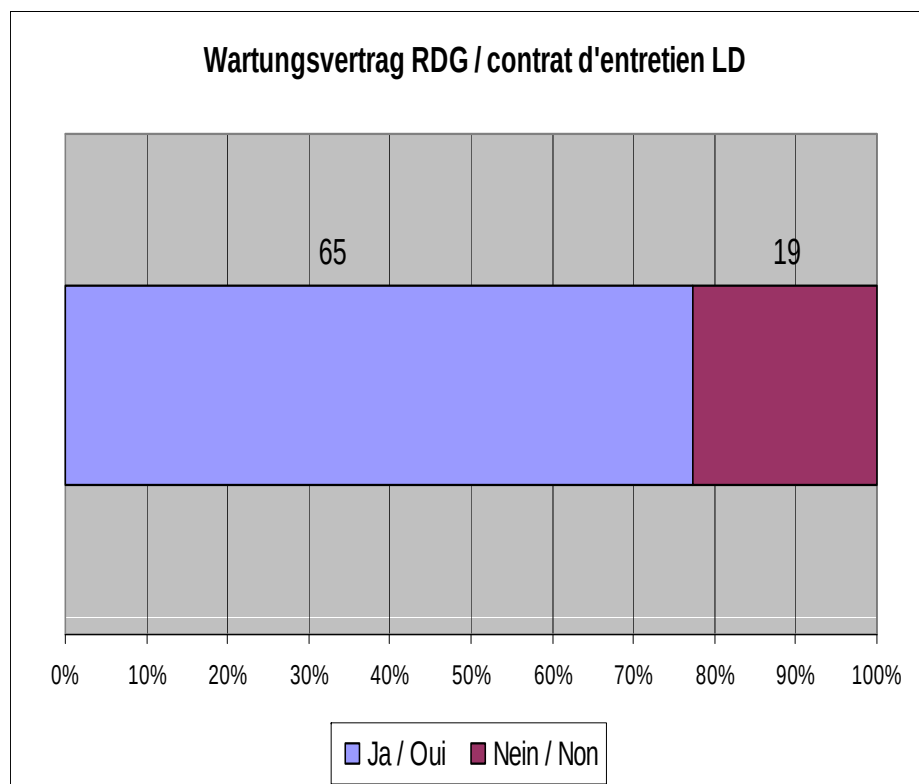


Possédez-vous des thermosoudeuses?

Anzahl Heissiegelgeräte / Nbr de thermosoudeurs

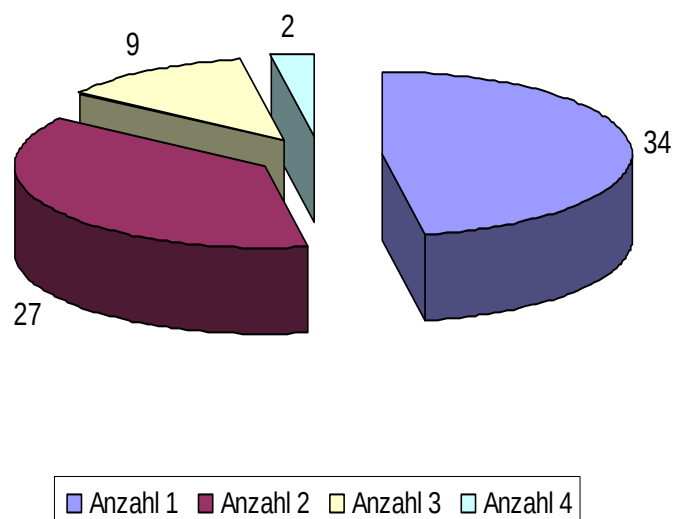


Wartungsvertrag Heissiegelgeräte /
contrat d'entretien pour thermosoudeurs

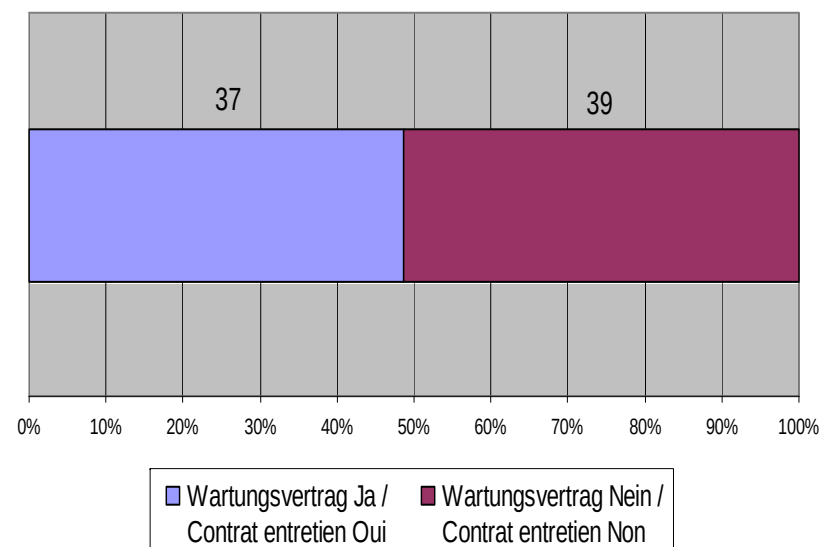

Vue d'ensemble Modes de stérilisation


		Vapeur		OE		VH2O2		Formaldéhyde		Autres	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Validation		75	94.94	4	57.14	26	92.86	0	0	2	3.17
Contrat d'entretien		68	87.18	6	100.00	21	80.77	0	0	?	?

Fréquence du test B&D (Bowie & Dick)

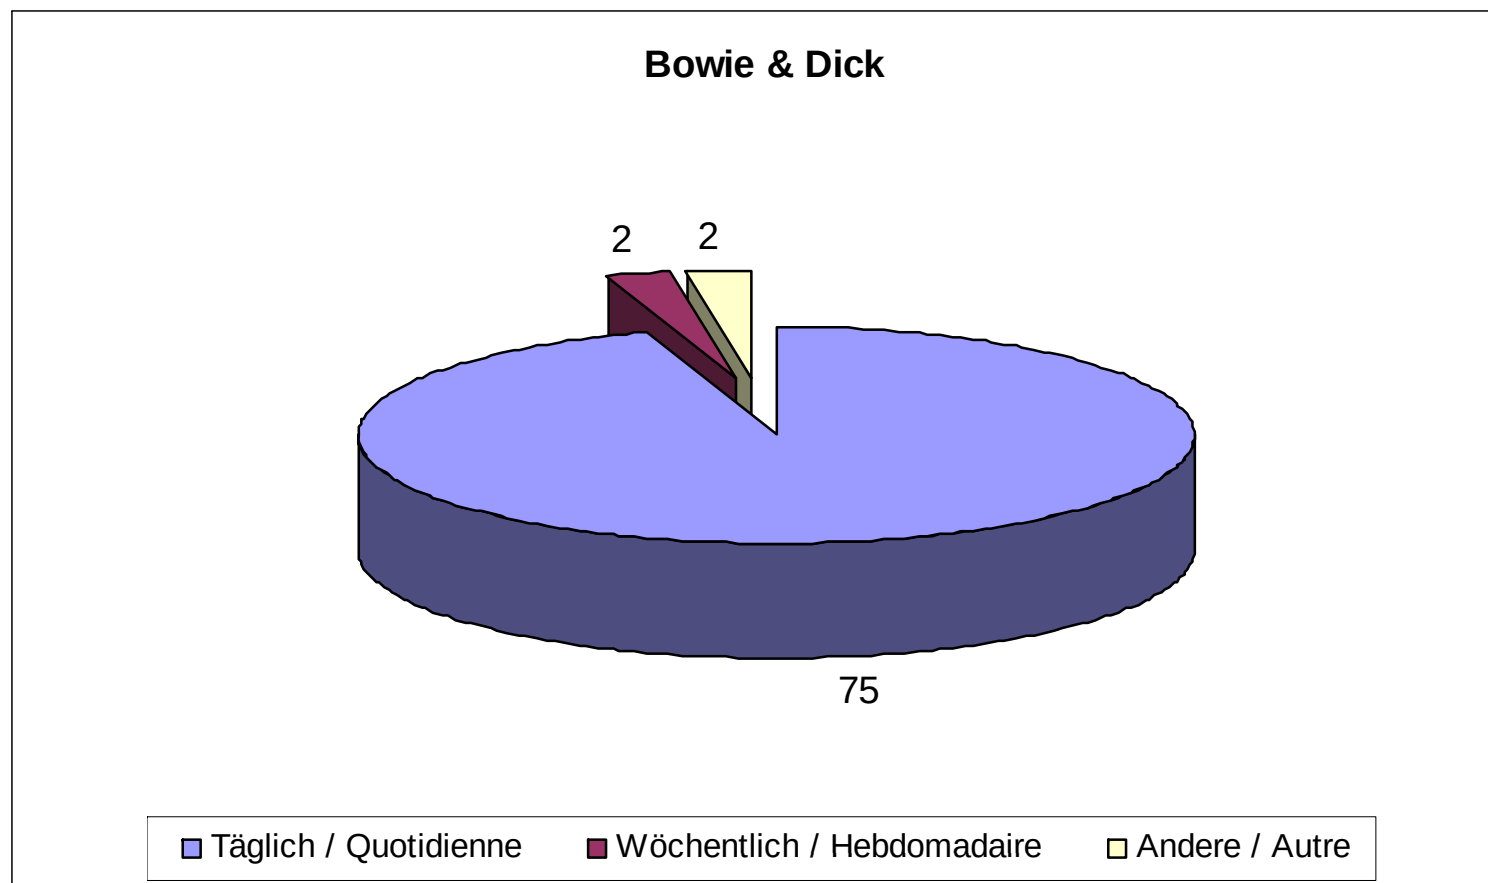


Stérilisateurs à vapeur


Validierte Dampfsterilisatoren /
stérilisateur à vapeur validés

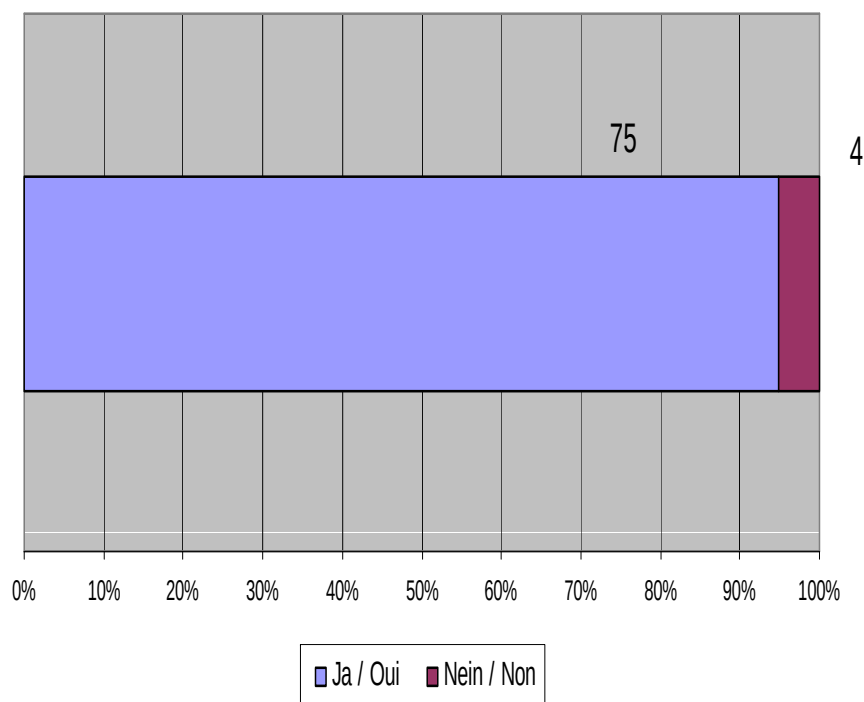





Wartungsvertrag Dampfsterilisator /
contrat d'entretien pour steri à vapeur

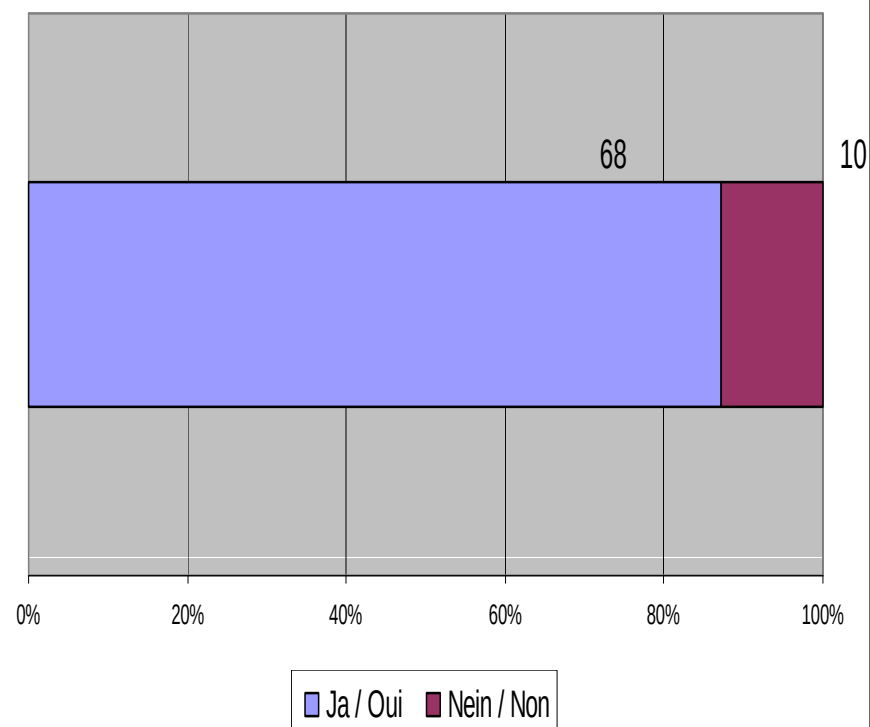




L'envoi d'un DM endommagé est faite par

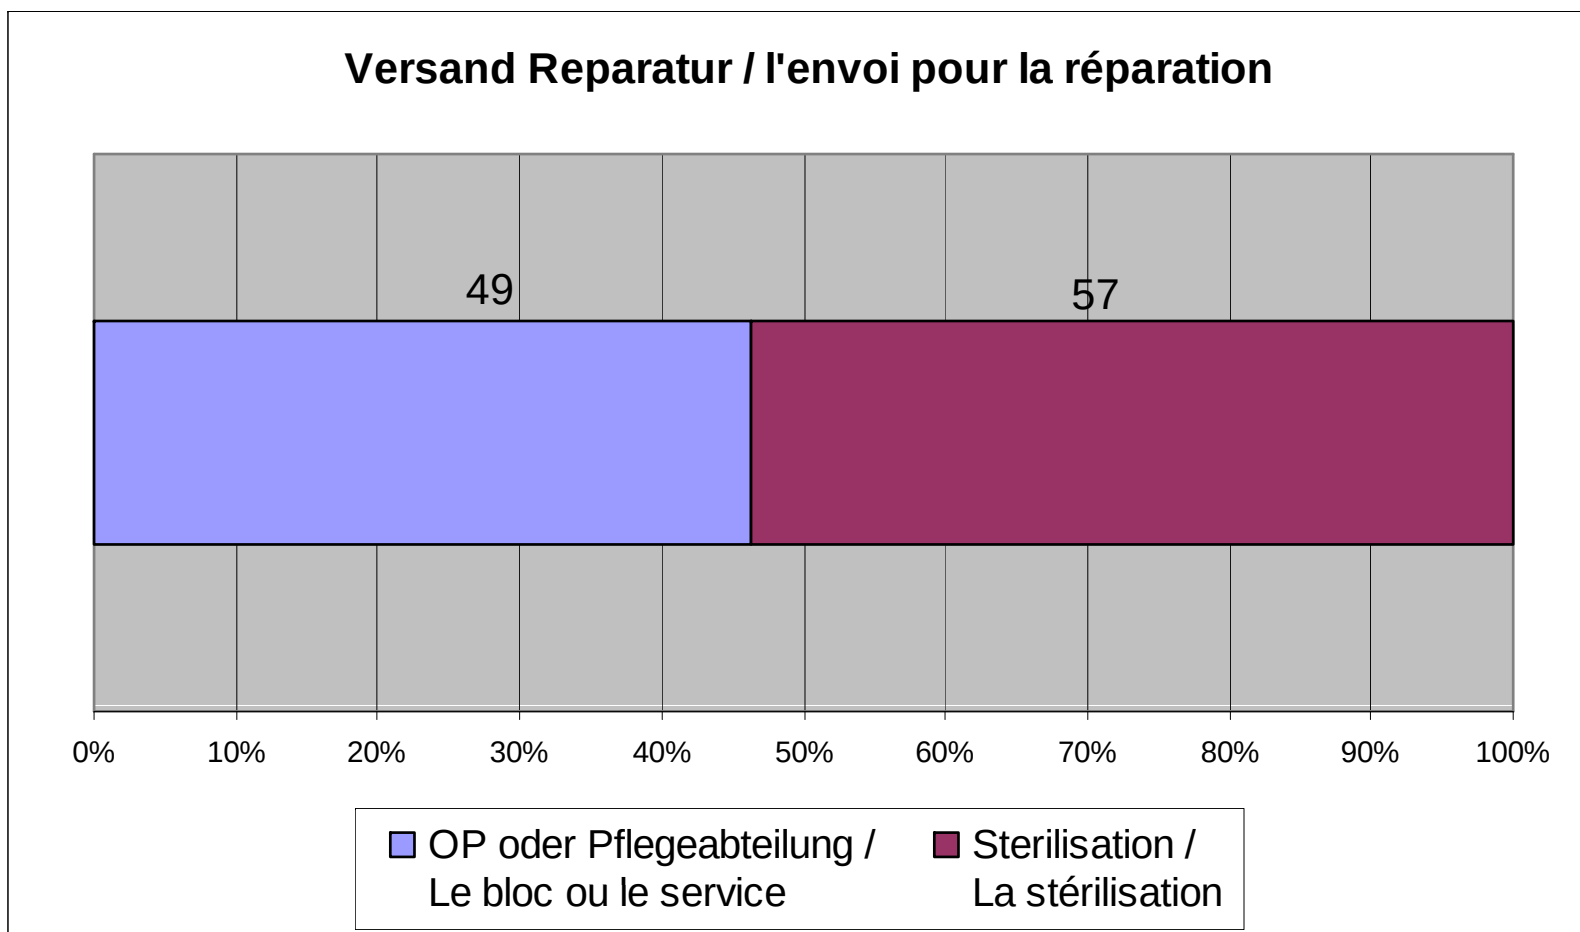



Différents contrôles

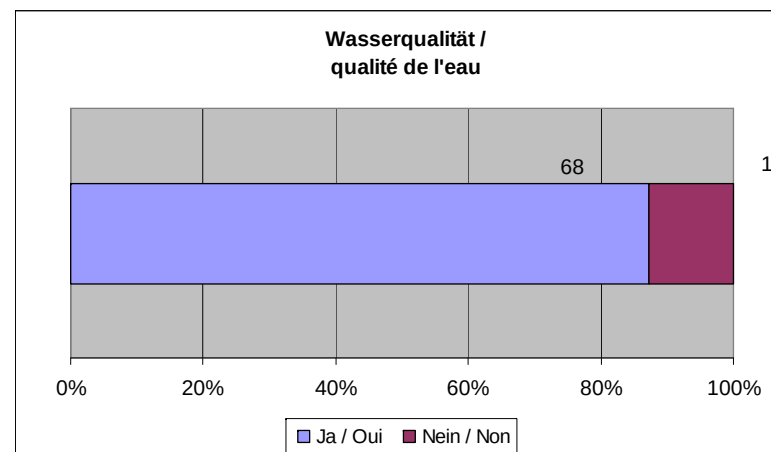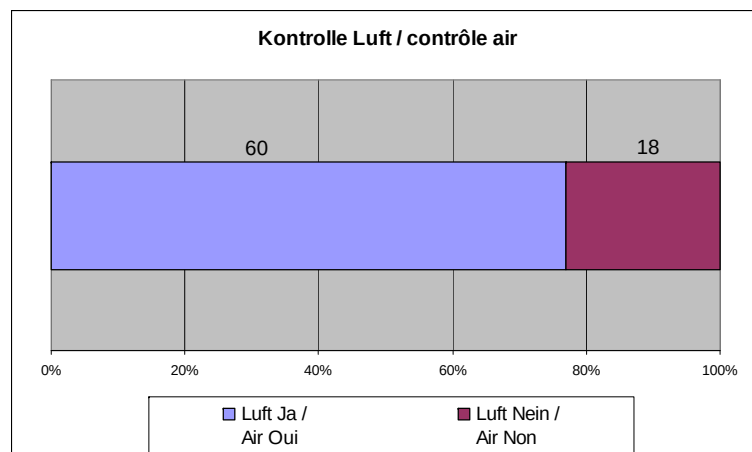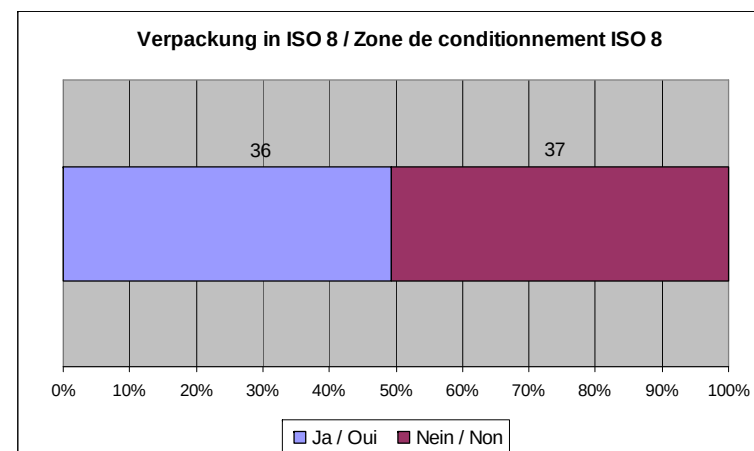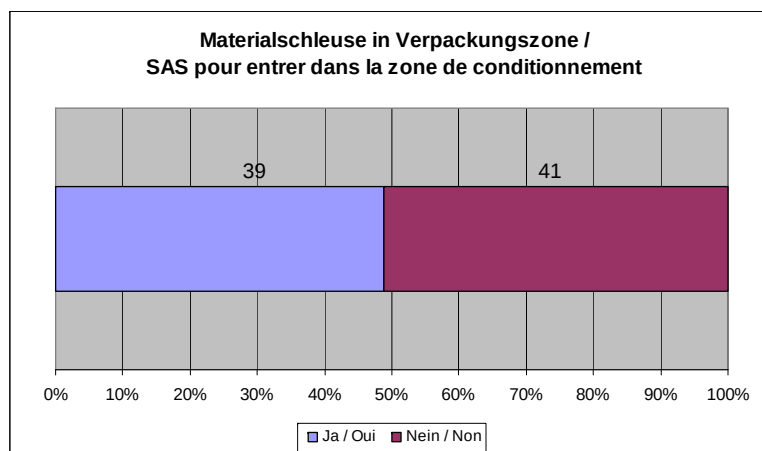

Documentation et traçabilité

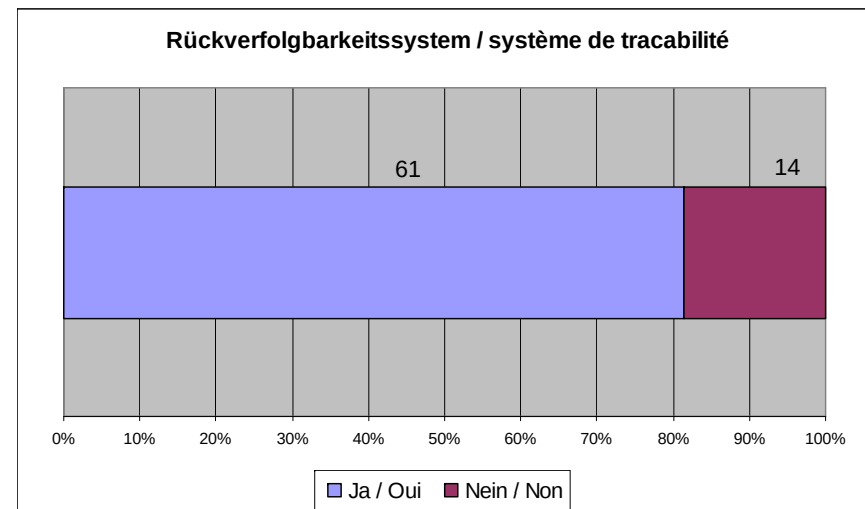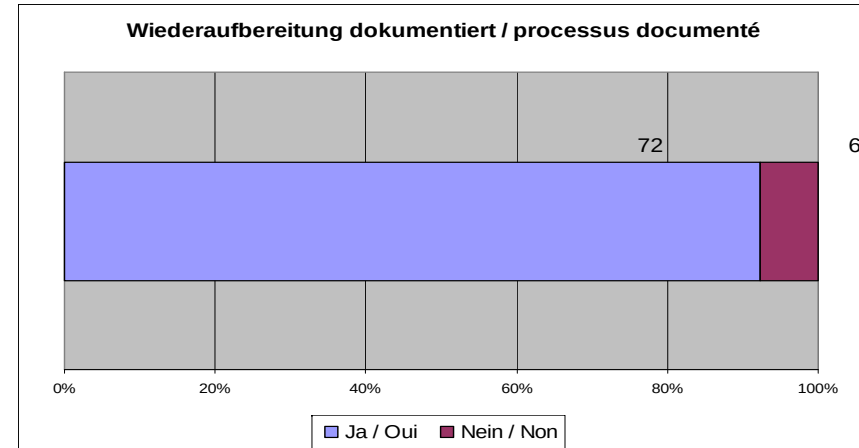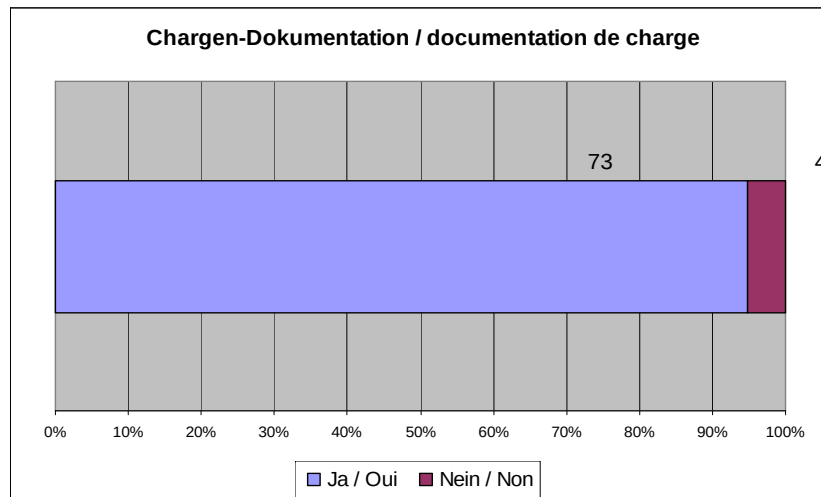

SGSV/ SSSH/ SSSO

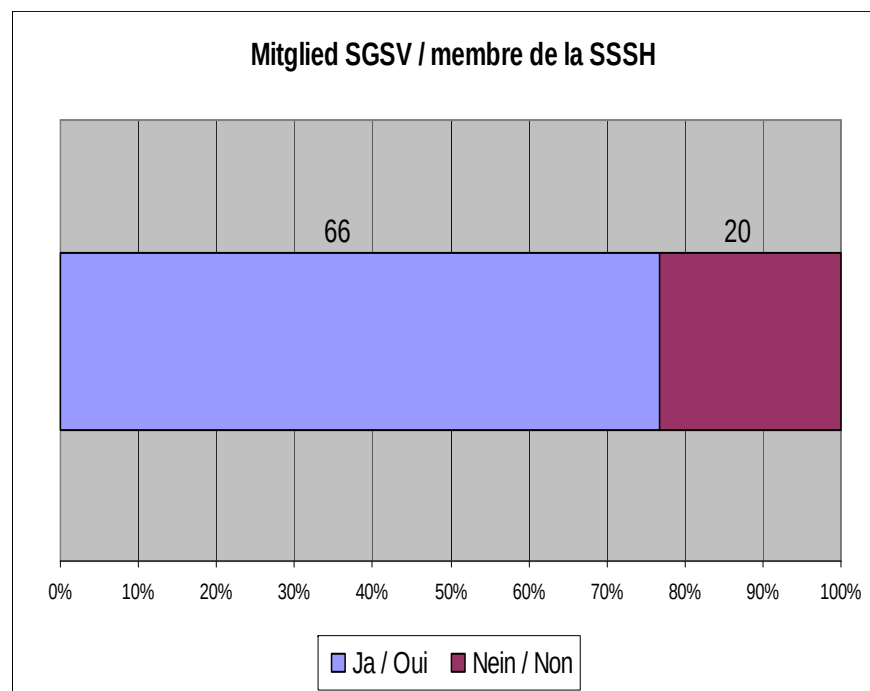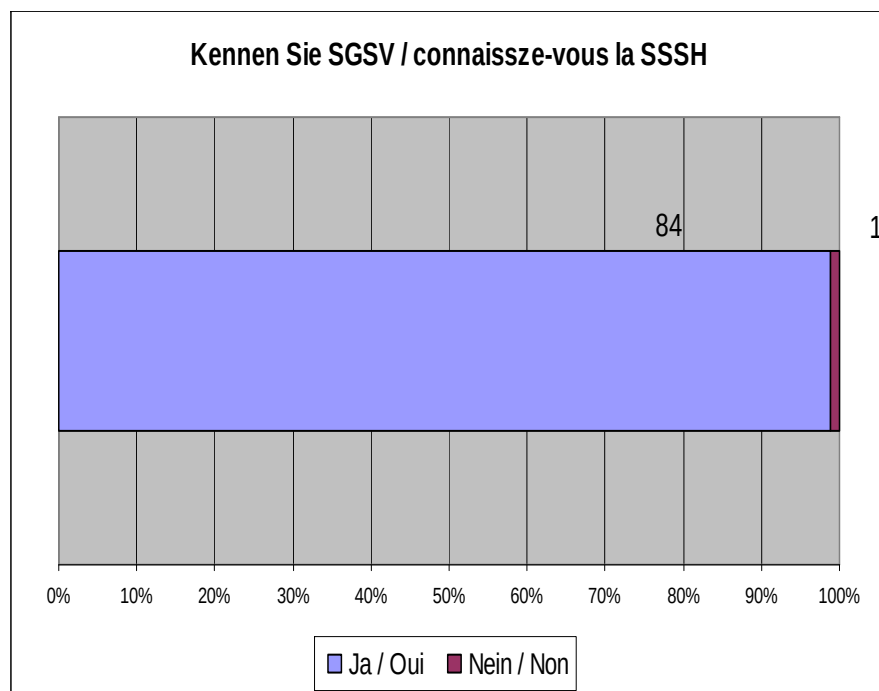

Autres approches possibles

- par région géographique
- par hôpitaux universitaires / cantonaux / de district (ou selon le nombre de lits)
- en fonction du genre de stérilisation

Et pour finir....

- Un grand merci à notre Président Frédy Cavin, qui s'est chargé de l'élaboration, de l'envoi et du premier dépouillement du questionnaire.
- Conséquences pour la SSSH?
- Questions?
- Merci de votre attention!

