

G.H.O.L

GROUPEMENT HOSPITALIER
DE L'OUEST LEMANIQUE S.A.

HÔPITAL DE ZONE DE NYON



ZSVA: im Zentrum der Anwender

«Das Schönste am Problem
ist die Lösung»

Guy Meyrier, Verantwortlicher ZSVA

Inhalt

Rückblick

Ist-Zustand – Unser Umfeld


Qualitätsmanagement

Rückverfolgbarkeit

Sicherheit

Referenzen

Schlusswort

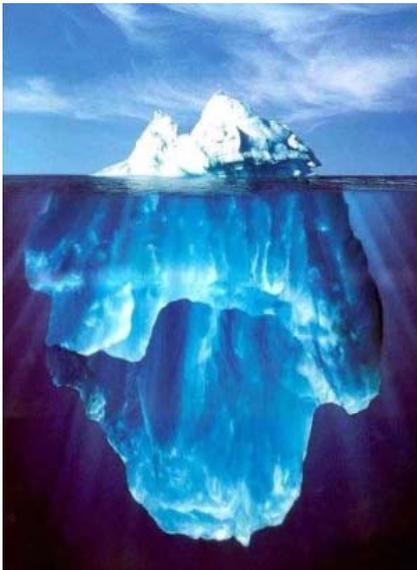

Rückblick

⇒ **Gründung**

⇒ **Einrichtung**

Unser Umfeld



2009 :

Anzahl Patienten : 7 099 für 43 206 Spitaltage, davon 621 Patienten auf der Intensivstation


Anzahl operativer Eingriffe, OP-Aktivität: 4202

17 502 Notfälle

100 000 aufbereitete MP davon 73 000 neu sterilisiert

Anzahl Zyklen mit Chargen (technische Zyklen ausgenommen) im Sterilisator: 3138, RDG: 4166

Unser Umfeld

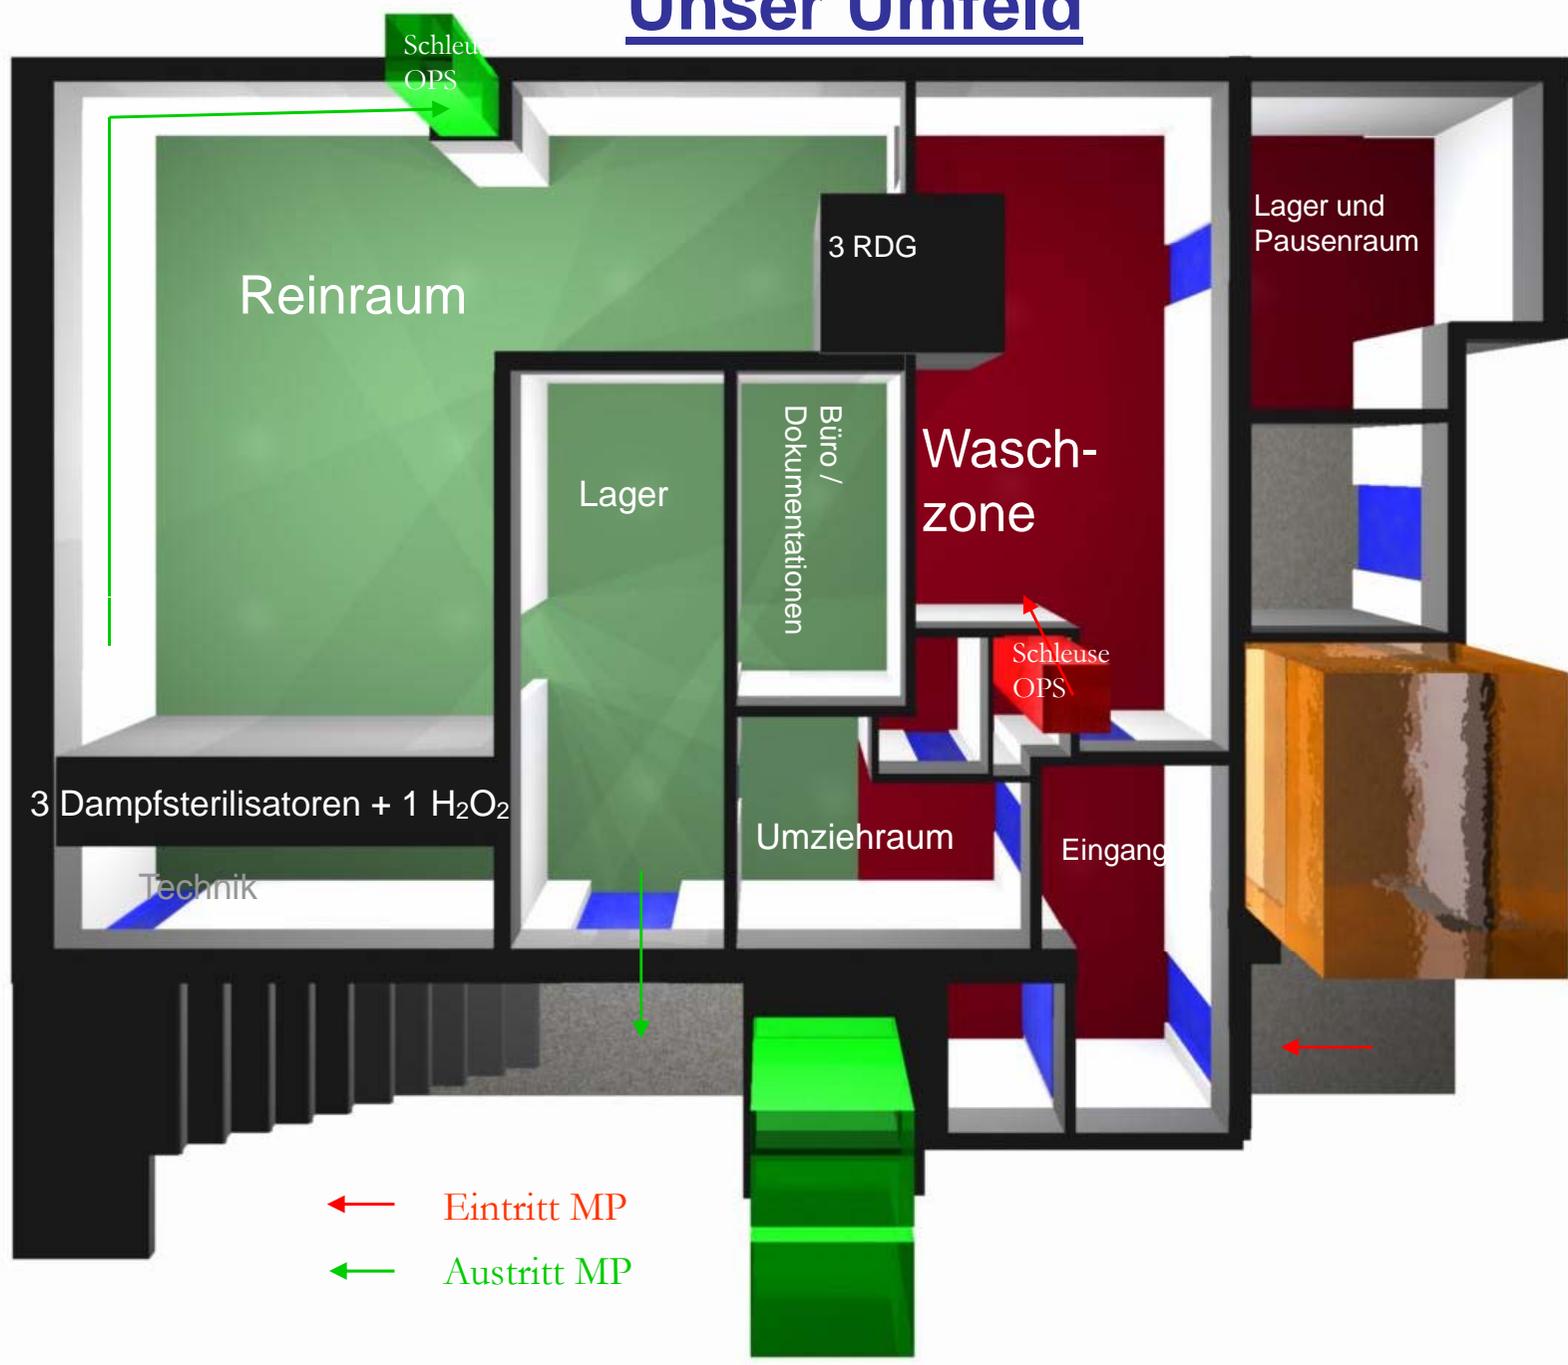

Überlegungen bei der Einrichtung

Beispiel:


- Individuelle Schutzausrüstung

- EDV:
 - Ausrüstungen,
 - EDV-System

- Was halten Sie von der ZSVA ?



Qualitätsmanagement

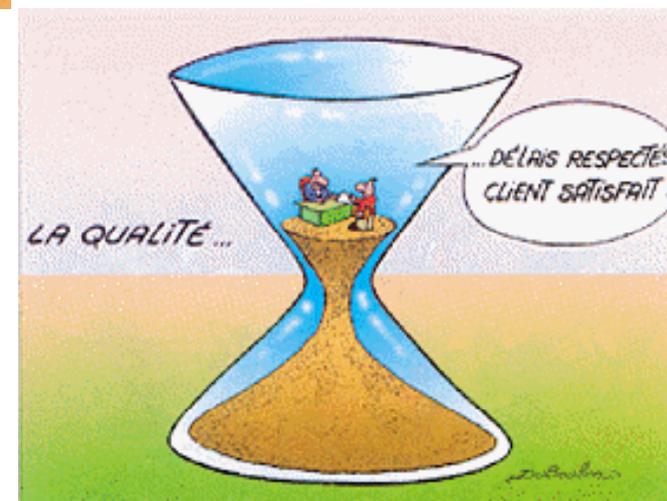

Aus/Weiterbildungen

Rückverfolgbarkeit – Dokumentationssystem

Unsere Vereinigung



DIE ZUKUNFT AUFBAUEN

Dokumentationssystem



Beispiel:

- Technische Informationen: schwarz
- Konformitätsmängel: rot



Horizon Ster


Bloc Opérateur - Opérateur - Chirurgien

Nous sommes aussi au Bloc opératoire ?



⇒ Oui et nous garantissons l'ASEPSIE du Dispositif Médical.

Suivi du Retraitement d'un Dispositif Médical (DM) en Centrale de Stérilisation G.H.O.L. Nyon venant du Bloc Opératoire

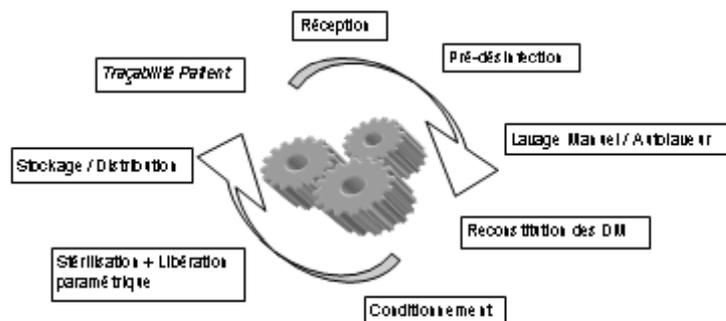

Le codage des DM attribue un numéro de fabrication individuel lors de chaque passage en stérilisation d'un produit afin de gérer l'historique des dispositifs médicaux réutilisables ou à usage unique.

Un Dispositif Médical a besoin de minimum 3 heures pour être retraiter avec une documentation de retraitement du DM présente et connue :

- 15 minutes de pré-désinfection
- 80 minutes de laveur-désinfecteur
- 20 minutes de contrôle et de conditionnement/étiquetage
- 55 minutes de stérilisateur
- 10 minutes de manipulations
- (Temps planifié si tous nos équipements sont libres)

Tout comme l'ensemble des secteurs d'activité hospitalier, l'objectif recherché est de garantir la sécurité d'une part des DM et d'autre part de nos patients ; nous pouvons collaborer ensemble en matière de suivi. A tout moment, et quelle que soit la situation, le procédé de retraitement des DM est démontré.

Ainsi nous retrouvons la traçabilité qui entre dans cette dynamique plus globale qu'est la démarche qualité.

Avec la certification ISO 13485 :2003 du service de Centrale de Stérilisation et ce système de traçabilité, nous sommes capable de :

- Créer un lien inviolable entre produit conditionné / stérile, cycle de stérilisation et patient
- Diminuer les risques d'erreur humaine
- Réduire les coûts de production
- Etre reproductible
- Faciliter la recherche de l'information
- Fournir instantanément la traçabilité montante et descendante de chaque DM
- Accroître la qualité de la preuve
- Simplifier et pérenniser l'archivage

Selon un processus d'amélioration continue, nous promovons la collaboration d'implication entre l'opérateur et le fabricant.

La Centrale de Stérilisation du G.H.O.L. est un site de production constitué d'une équipe formée pour une reproductibilité de retraitement du DM selon les législations en vigueur et nos procédures.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement avec pour ligne de conduite :

« Conseil – Collaboration – Concertation – Coordination – Communication »

Guy MEYRIER, Référent responsable de la Centrale de Stérilisation
022 994 62 46
guy.meyrier@ghol.ch



Quelques chiffres :

pour 2008 :

- 5115 cycles de stérilisation ↔ 70558 dispositifs médicaux stérilisés
- 84031 dispositifs médicaux conditionnés
- 43 clients : services, cabinets médicaux, établissements extérieurs, particulier et actions humanitaires.
- 1610 litres de détergents - désinfectant
- 20 491 m² de papier utilisé (3 terrains de football).

ZUSAMMENARBEIT



TEAMGEIST

- Bei jedem Kontakt mit «Kunden»
- In unserem Team

Aus/Weiterbildung

Offenes Ohr

Follow-up



Instrument Micro Chir **GPDP** Prétraitements -1-5-
 Cycle de stérilisation: -134-
 Peremption (j) 90
 101101




... durch Grundausstattung

Quantité	Articles	Prétraitement	Code	Clé	Réutilisable	Coût
1	101101 pince mosquito droit		000880	AAA	Réutilisable	
1	101101 ciseau courbe		000881	AAC	Réutilisable	
1	101101 ciseau à dénudé		000882	AAC	Réutilisable	
1	101101 ciseau à droit		000883	AAC	Réutilisable	
1	101101 centimètre N°1		000884	ABM	Réutilisable	
1	101101 centimètre N°2		000885	ABM	Réutilisable	
1	101101 pincette à griffe fine N°1		000886	AAD	Réutilisable	
1	101101 pincette à griffe fine N°2		000887	AAD	Réutilisable	
1	101101 pincette à griffe fine N°3		000888	AAD	Réutilisable	
1	101101 pincette à griffe fine N°4		000889	AAD	Réutilisable	
1	101101 pincette pointu		000890	AAD	Réutilisable	
1	101101 porte aiguille spécial N°1		000891	AAB	Réutilisable	
1	101101 porte aiguille spécial N°2		000892	AAB	Réutilisable	
1	101101 ciseau spécial N°1		000893	AAC	Réutilisable	
1	101101 ciseau spécial N°2		000894	AAC	Réutilisable	

... nigung von Hand /
 ... ilisator

... olle MP

Verpackung und Etikettierung


Sicherheit

- Sicherheit der Medizinprodukte und unserer Patienten garantieren
-
- Funktionskontrolle MP

Referenzen


- AMCOR /Cosanum : Sterigest-Dokumente
- Zeitschrift : Hygiènes Nov-Dez 2009
- Masterkurs Qualität und Organisation, DEPULP Université Louis Pasteur Strasbourg (F)

LEHRPLANSVA

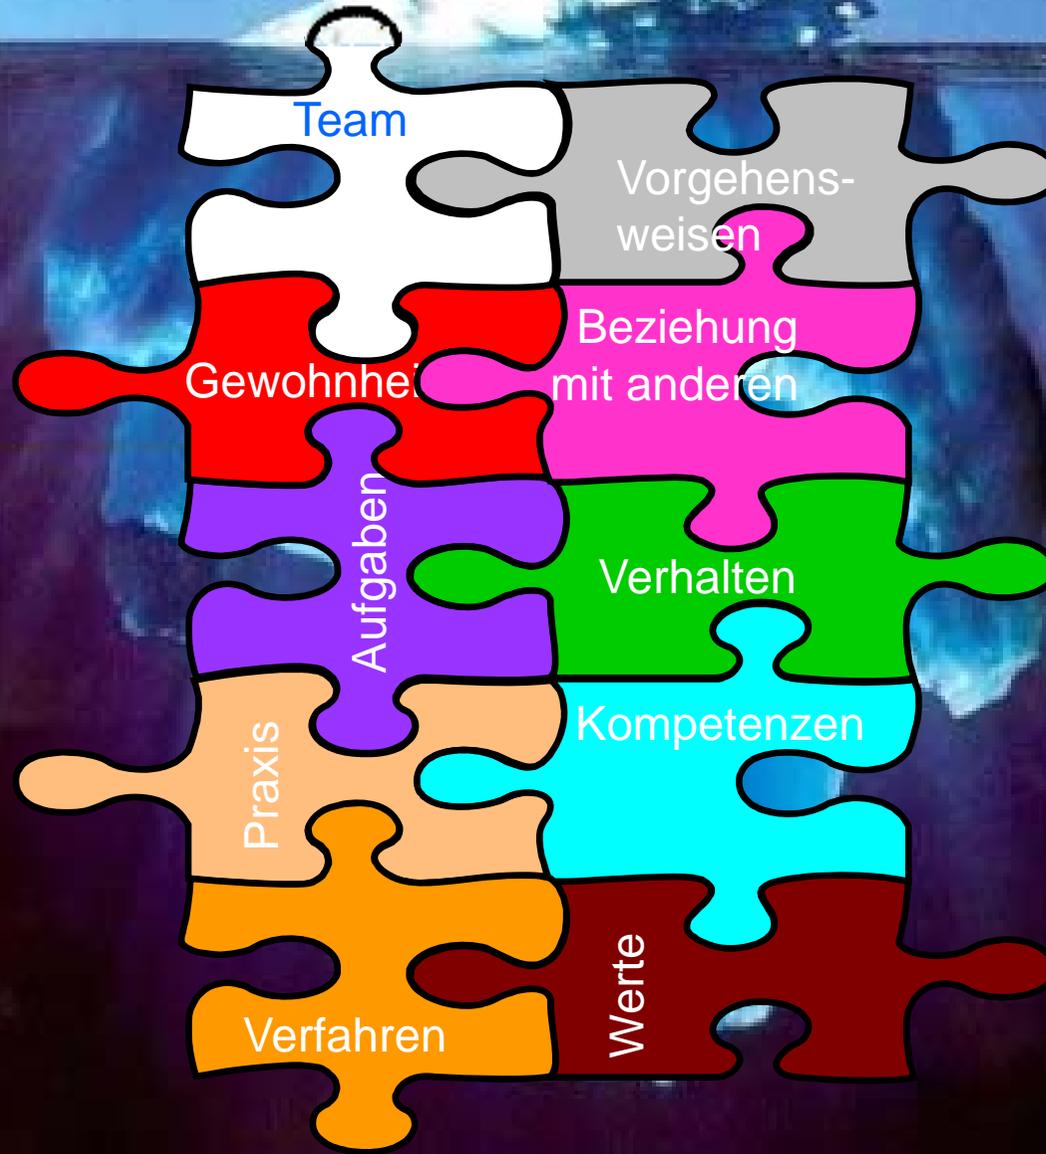

Unsere Zentralsterilisation: «eine bunte aber weise Mischung»





G.H.O.L.

GROUPEMENT HOSPITALIER
DE L'OUEST LEMANIQUE S.A.

HÔPITAL DE ZONE DE NYON



Schlusswort

Ein Problem sieht, wenn es einmal gelöst ist, immer einfach aus.

Paulo Coelho

Danke für Ihre Aufmerksamkeit